



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Μαυριωτίσσης 33
521 00 ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Αθήνα, 24/4/2017

**Αφορά: ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ
Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΥΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»**

Είδος 05: ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ 48 ΘΕΣΕΩΝ

Αναφερόμενοι στην ανωτέρω διαβούλευση για τις τεχνικές προδιαγραφές ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, έχουμε τις εξής παρατηρήσεις σε δύο τεχνικές προδιαγραφές του ανωτέρω είδους:

Τεχν.προδ. 10

Να αλλάξει η 2^η παράγραφος ως εξής: «Να διαθέτει καπάκι είτε η κεφαλή, είτε τα καλάθια της κεφαλής, ώστε να απομονώνεται ο χώρος φυγόκεντρησης από τον εξωτερικό χώρο του κάδου».


Τεχν.προδ. 11

Να μπει ένας ελάχιστος αριθμός προγραμμάτων, π.χ. πέντε (5).

Επιπλέον, επειδή μέσω της διαύγειας πληροφορηθήκαμε τον ενδεικτικό προϋπολογισμό για το είδος 4 (φυγόκεντρος 24 θέσεων) € 7.500 και το είδος 5 (φυγόκεντρος 48 θέσεων) € 11.000, θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι θα πρέπει τα ανωτέρω ποσά να αυξηθούν τουλάχιστον κατά 20% (είκοσι τοις εκατό), για να υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει ανταγωνισμός και να συμμετάσχουν Εταιρείες στα συγκεκριμένα τουλάχιστον είδη.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

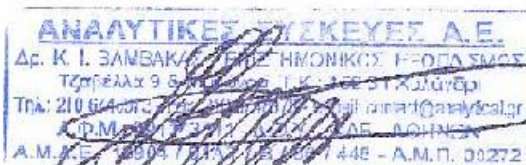

Α. Ζιλλιερόν